

**myobrace®**

## INTERCEPTIVE CLASS III

INTERCEPTIVA CLASE 3

### DENTICIÓN MIXTA

Utilizar una  
hora al día  
y por las  
noches al  
dormir

i-<sup>3</sup><sup>N</sup>

[www.myobrace.com](http://www.myobrace.com)

Tenemos pacientes alrededor del mundo. Para más información visitar [myoresearch.com](http://myoresearch.com)

## ¿Qué causa los problemas de ortodoncia?

La mayoría de nuestros hijos desarrollará dientes apiñados y alineación incorrecta de la mandíbula. Estudios actuales han demostrado que la respiración por la boca, interposición lingual, deglución atípica y chuparse el pulgar – conocidos como malos hábitos miofuncionales – son la causa real de los dientes torcidos. Estos hábitos limitan el desarrollo de las mandíbulas y cara del niño que resultan en problemas de ortodoncia. Estas causas no se pueden corregir con Brackets.

### Dientes normales contra apiñados

La función de la lengua, las mejillas y los labios determina la posición de los dientes. El crecimiento facial correcto depende de una función y patrones de respiración correctos.



**APIÑADOS**  
ARCO SUPERIOR



**NORMALES**  
ARCO SUPERIOR

**NOTA: EL TAMAÑO DEL DIENTE NO HA CAMBIADO**

# **Myobrace® Interceptive Class III**

*Myobrace® Interceptive Clase III* es un sistema de aparatos de tres etapas diseñado específicamente para corregir los malos hábitos orales excesivos y limitar los problemas de desarrollo más bajos de la mandíbula comúnmente asociados con los pacientes que tienen clase III. *Myobrace® Interceptive Clase III* es más efectivo antes de los dientes permanentes del niño (edades de 5 a 8) y está disponible en tres tamaños.

## ***Myobrace® Interceptive Class III – características de diseño***

Etapa uno – corrección del hábito



**Material flexible –**  
para uso en casos de inicio más extremos y aceptación y comodidad mejorada del paciente.

**Lengua, Escudo Lingual, y elevadores –**  
entrenar a la lengua a situarse correctamente.

**Orificios de respiración pequeños y forma de arco doble –** impide la respiración por la boca (un problema común en pacientes de Clase III).

**i-3<sup>N</sup>**

# Instrucciones de uso:

Use su aparato *Myobrace*® durante una o dos horas diarias y durante toda la noche al dormir.

Sus dientes se podrían poner un poco sensibles durante las primeras etapas del tratamiento. Es bastante normal pero si el dolor llega a ser excesivo, reduzca el tiempo de aplicación y avise a su médico.




**Paso 1** – Sujete el *Myobrace*® con la lengua hacia arriba.



**Paso 2** – Coloque el *Myobrace*® en su boca.



**Paso 3** – Mantega su lengua en la lengüeta.

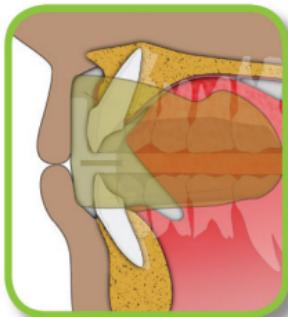

**Paso 4** – Cierre el *Myobrace*® y siénta como alinea sus dientes frontales y mandíbulas.



**Paso 5** – Mantenga sus labios juntos y respire por su nariz.

**¡No mastique su *Myobrace*®!**

**El *Myobrace*® puede caerse durante la noche al dormir en las etapas iniciales del tratamiento. Si ello sucede, aumente el uso durante el día.**

# ¿Cómo funciona?


MRC ha liderado el uso de aparatos para corregir hábitos miofuncionales en niños en crecimiento y ha demostrado el éxito en la corrección de los problemas dentales sin brackets. Este tratamiento puede también llevar a un mejor desarrollo facial en niños en crecimiento. La clave de este tratamiento es corregir la posición y función de la lengua, obteniendo respiración nasal correcta y re-entrenando a los músculos orales a funcionar correctamente.

Los aparatos *Myobrace®* enseñan eficazmente a la lengua a situarse correctamente en el maxilar superior, re-entrenan la musculatura oral y ejercen fuerzas ligeras para alinear los dientes.


## Objetivos del tratamiento:

- Labios cerrados todo el tiempo excepto al hablar o comer.
- Respirar por la nariz para ayudar al desarrollo de las mandíbulas superior e inferior y lograr el bocado correcto.
- Ninguna actividad labial al traguar para que permita a los dientes anteriores a desarrollarse correctamente.
- Mejora la alineación dental.
- Mejora el desarrollo facial.


**Para que funcione el *Myobrace®*, usted debe corregir sus malos hábitos miofuncionales.**

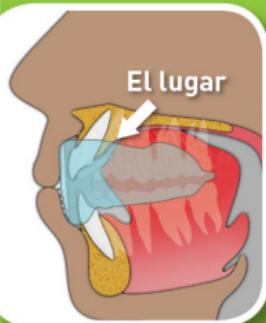

Posición correcta de reposo

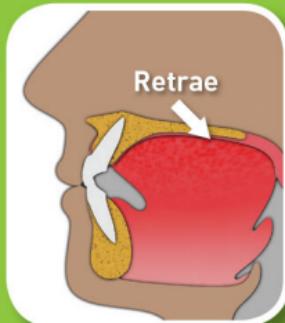

Patrón correcto de deglución

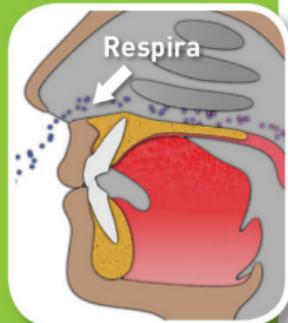

Consciencia de respiración

# Indicaciones de uso:

**Myobrace® Interceptive Class III** es un sistema de aparatos orales de tres etapas diseñado específicamente para corregir malos hábitos orales y limitar problemas excesivos de desarrollo de la mandíbula superior e inferior.

Los aparatos corren los malos hábitos miofuncionales que son la causa de los dientes torcidos, mientras que brindan pequeñas fuerzas para ayudar a expandir la mandíbula superior y alinear los dientes en su posición correcta.

## Consideraciones del tratamiento

La duración del tratamiento puede variar dependiendo de la adaptabilidad biológica de cada paciente. Los aparatos orales *Myobrace®* se debe usar diariamente para un resultado exitoso. La supervisión regular de su dentista o ortodoncista es esencial para el tratamiento exitoso y evitar complicaciones de tratamiento no deseadas.

**Aseo de su Myobrace®:** Lave su aparato oral *Myobrace®* bajo con agua tibia cada vez que se lo quite de su boca. Use tabletas *Myoclean®* para asear bien dos veces a la semana. Consulte a su médico o terapista dental sobre *Myoclean®*, su agente de limpieza recomendado para todo aparato *MRC*.

## ADVERTENCIA: USAR SOLO BAJO LA SUPERVISION DE UN ORTODONCISTA O DENTISTA AUTORIZADO.

Tiempo de vida útil: 6 meses usado de forma diaria.

Substituir después de 12 meses sin importar el tiempo de uso.

**Myobrace® por Myofunctional Research Co.**

**Myofunctional Research Co. Australia**

44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia

Tel: +61 7 5573 5999

*Uso unipersonal*



**MYOFUNCTIONAL  
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE  
TECHNOLOGY AND EDUCATION

Representante en EEUU:

Myofunctional Research Co. USA

9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA

P.O. Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA

Tel: +1866 550 4696



Representante en Europa:

Myofunctional Research Europe B.V.

Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands

P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands

Tel: +31 416 651 696



Myobrace\_I3N\_INS\_0817\_ESP\_v1.2.0\_EU